


CÓMO RECONSTITUIR

BRAVECTO[®]
inyectable

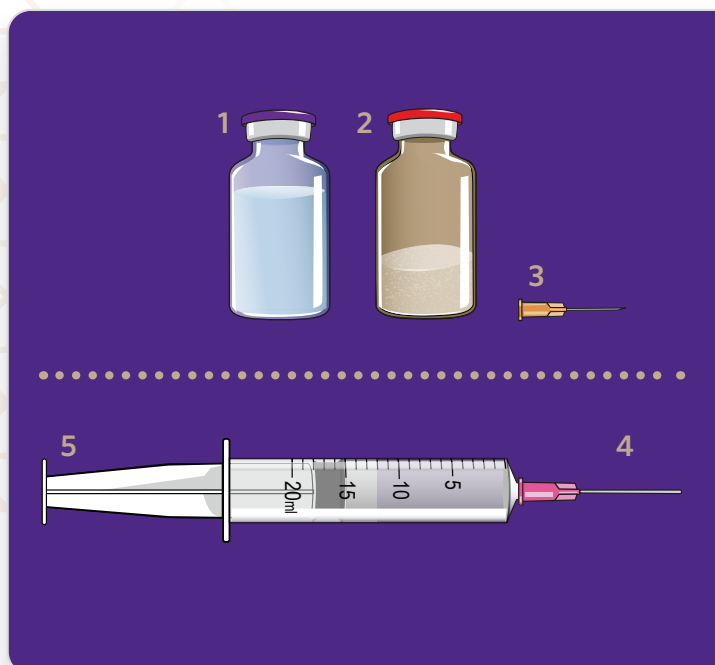

El envase contiene:

- Vial de disolvente (1)
- Vial de fluralaner en polvo (2)
- Aguja de ventilación estéril (25 G) (3)
- Prospecto


Necesitarás:

- Aguja de transferencia estéril (18 G) (4)
- Jeringa estéril de 20 ml (5)

Para asegurar la eficacia del tratamiento, es importante mezclar correctamente la suspensión antes de la inyección y utilizar los tamaños de aguja y jeringa indicados en el prospecto del medicamento.




1 Comienza agitando el vial de fluralaner en polvo para romper los agregados antes de la reconstitución.

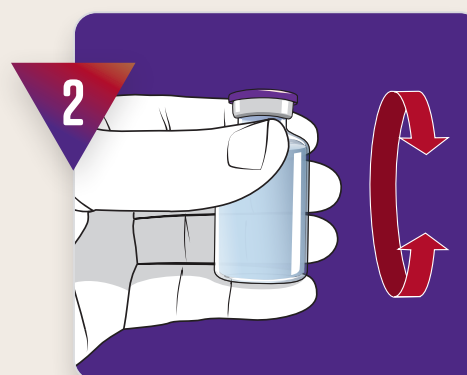

2 Invierte el vial de disolvente al menos **3 veces** hasta que el contenido sea visiblemente uniforme. El contenido del vial de disolvente es una solución viscosa transparente a opaca.


Las instrucciones continúan en la siguiente hoja...

COMO RECONSTITUIR BRAVECTO[®] inyectable

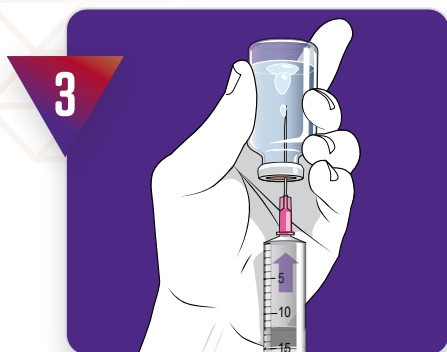


Retira la cápsula morada del vial de disolvente estéril. Utilizando la aguja de 18 G y la jeringa de 20 ml, inyecta aproximadamente 14 ml de aire en el vial de disolvente.


A continuación, extrae 15 ml de disolvente del vial. Es importante tener en cuenta que en el vial hay más disolvente del necesario para la reconstitución.

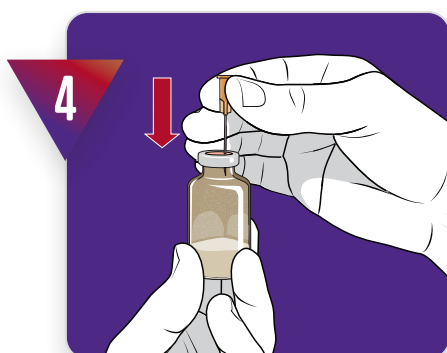

Retira la cápsula roja del vial de fluralaner en polvo. **Inserta la aguja de ventilación de 25 G** en la parte superior de dicho vial.

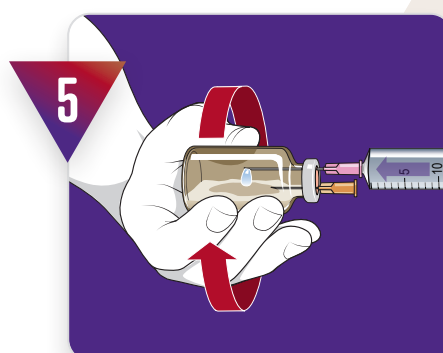

Mientras giras el vial horizontalmente en la mano, transfiere lentamente los 15 ml de disolvente al vial de fluralaner en polvo para garantizar la humectación completa del polvo.

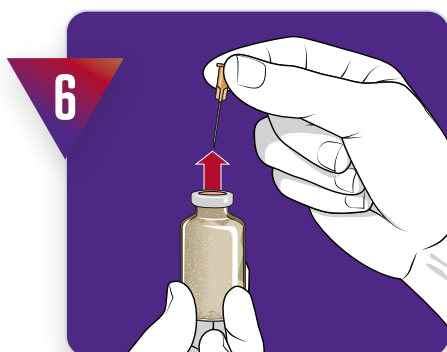

Una vez añadido el disolvente, retira las agujas de ventilación y de transferencia del vial de fluralaner en polvo y desecha las agujas.



Agita el vial enérgicamente durante al menos 30 segundos hasta que se forme una suspensión completamente homogénea. **Antes de cada uso, agita enérgicamente el vial reconstituido durante 30 segundos para conseguir una suspensión uniforme.**

BRAVECTO[®] inyectable debe almacenarse a una temperatura inferior a los 30 °C durante un máximo de 3 meses desde la fecha de la reconstitución. Desecha el vial reconstituido después de 20 perforaciones o si han pasado más de 3 meses desde la reconstitución.

Para más detalles, puedes ver el vídeo explicativo:



Ficha técnica
de BRAVECTO[®]
inyectable

En caso de duda, consulte con su veterinario.

Copyright © 2023 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates.
All rights reserved. ES-BRV-231200011 12/23

